

ドリルフローチャート



InterActive™

インタラクティブ


KaVo Kerr
Group




The Implant Direct Joint Venture is part of the KaVo Kerr Group

ドリルの回転は
600~1,250rpmを
推奨いたします。

3.2mmD

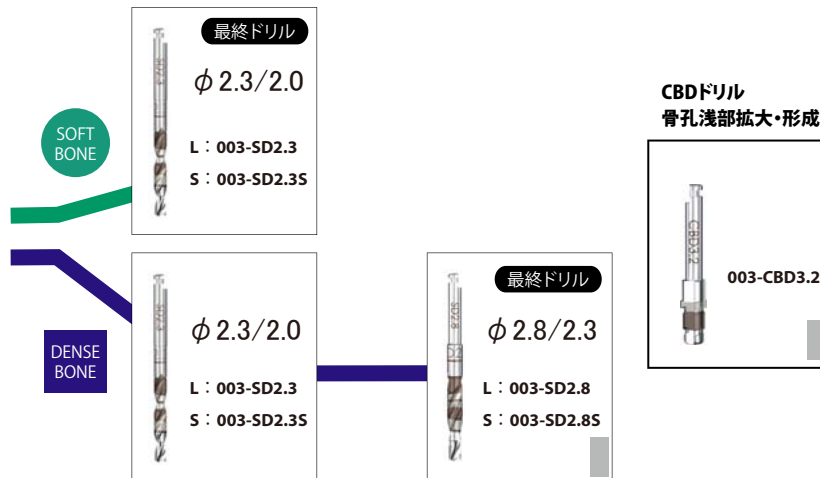

3.7mmD

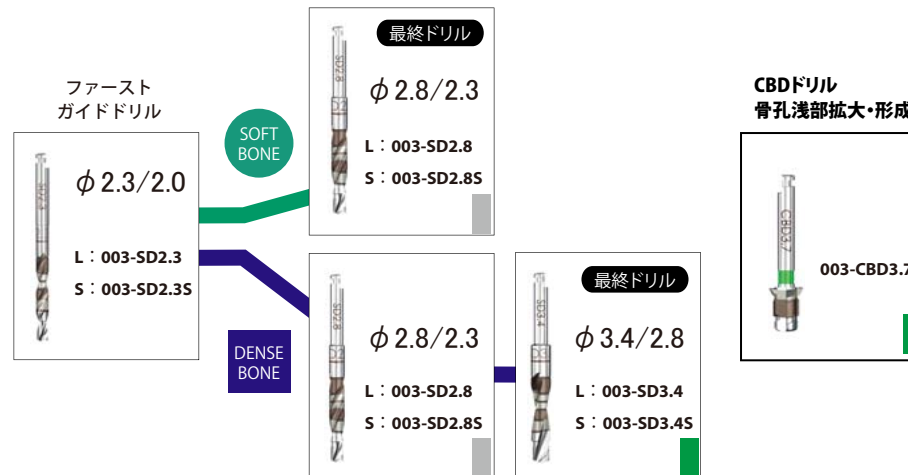

ドリルフローチャート



InterActive™

インタラクティブ


KaVo Kerr
Group



The Implant Direct Joint Venture is part of the KaVo Kerr Group

ドリルの回転は
600~1,250rpmを
推奨いたします。

4.3mmD

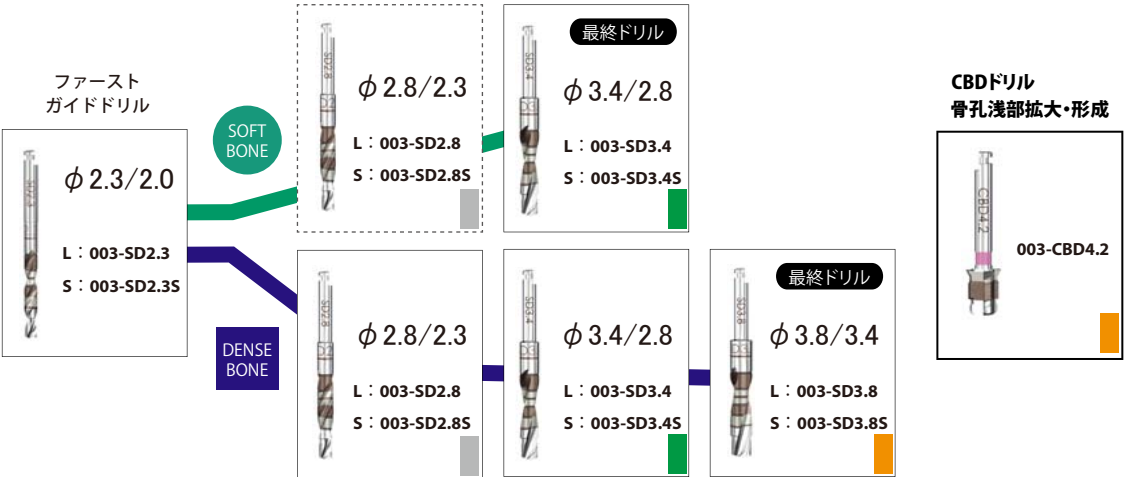

5.0mmD

