


3.3mmD




ドリルフローチャート




The Implant Direct Joint Venture is part of the KaVo Kerr Group

4.1mmD

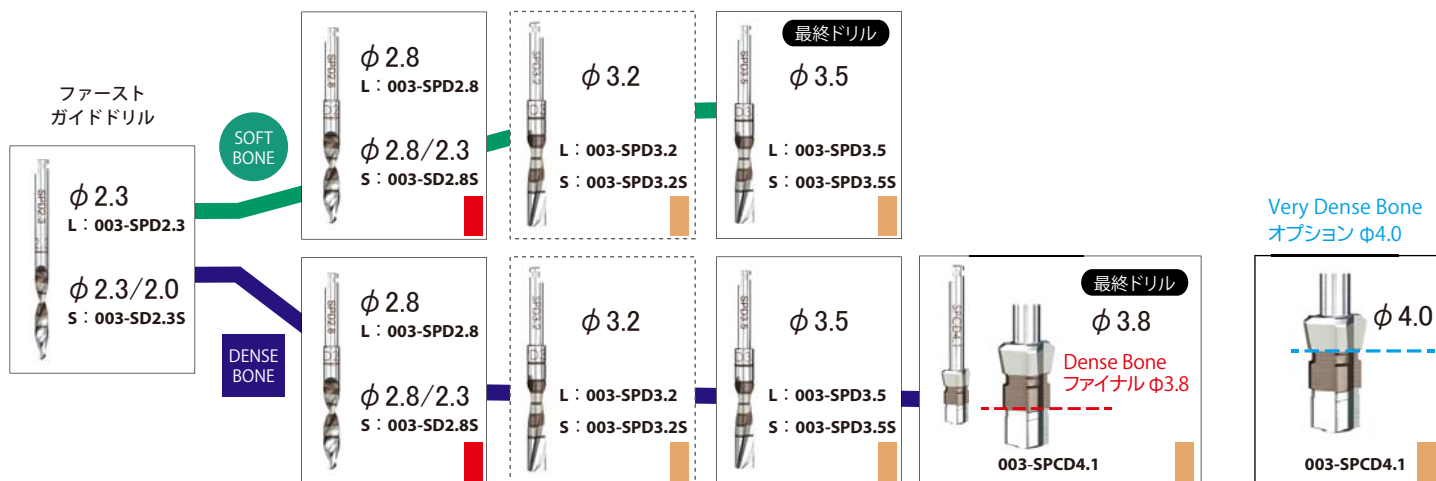

ドリルの回転は
600~1,250rpmを
推奨いたします。

4.8mmD

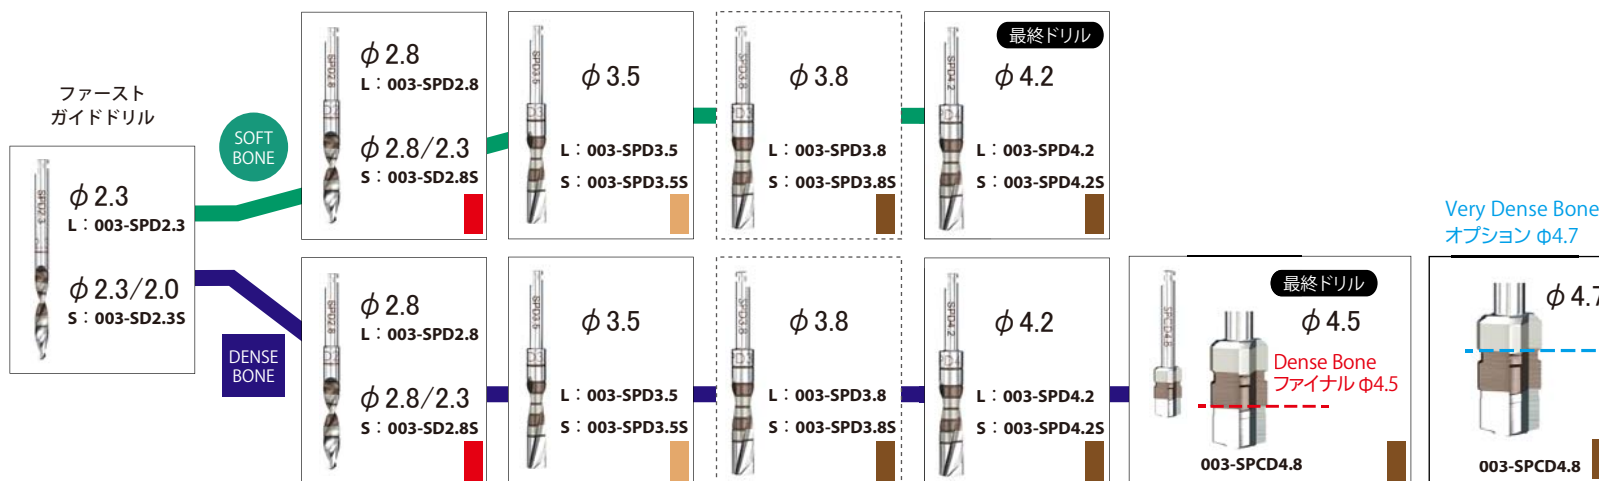

スクリー固定式(SCR)
アバットメント15°・30°
(角度付き)を使用する場
合は、カウンターシンクド
リル (003-SPCD4-6) での
最終形成を推奨。

